

デジタル温湿度計

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

K-EYUCA www.keyuca.com

販売元：河淳株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-15-1

この製品は行き届いた品質管理のもとで生産されていますが、
万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

輸入元：株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター  0120-875-019

URL : <https://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)

〈保証規定〉

- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合には本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。無料で修理、調整いたします。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
 ※誤ったご使用、不注意、落下、不当な修理、分解、改造、天災、地変等や異常電圧などの外部要因等による故障または損傷。
 ※ご使用上に生じる外観の変化。
 ※本書に販売店、およびお買い上げ年月日の記載がない場合、字句を書き換えられた場合。
 ※本書のご提示がない場合。
 ※一般家庭以外（例として、商用など）に使用された場合の故障および損傷。
- 電池は保証対象外です。
- 有料修理の場合、修理品の運賃、修理部品代、技術料はお客様にてご負担願います。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって、保証書を発行している者およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 (This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 安全上のご注意を守らないことにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。

お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますのでご了承ください。また、法令の定めのある場合を除き、事前の同意をいただくことなく、上記の目的以外には使用いたしません。

〈保証書〉

本保証書記載内容によりこの製品を保証いたします。

本製品の修理は本保証書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店へご相談ください。

品番	0-402		
保証期間	お買い上げ日より	1年間	※本体 持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 お電話		
販売店*	販売店名 ご住所 お電話		

販売店様へ：* 欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意

- 必ずご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する内容ですので、必ずお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

△ 警告

- 絶対に分解・修理・改造をしない。
 発火・感電・けがの原因になります。
- 通気口の穴にピンや異物などを入れない。
 内部の電気回路がショートして発火・感電・けがの原因になります。
- 本体を水につけたり、水洗いをしない。
 防水・防滴構造ではないため、感電・ショートのおそれがあります。
- 異常・故障がある場合は直ちに使用を中止し点検・修理を依頼する。
 発火・感電・けがの原因になります。
- 乳幼児の手の届くところに置かない。
 誤飲・けがの可能性があります。

△ 注意

- 防水・防滴構造ではないため、湿気の多い場所や水のかかる場所で保管・使用はしない。
- 落としたり、ぶつけたりなど強い衝撃を与えない。
- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所に置かない。
- 本体の上に物を置いたり、上に乗ったりしない。

- 本製品は医療用・業務用ではありません。一般的な日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 本製品を商取引や公に温度・湿度を証明する場合には使用しないでください。誤差による二次的な損害等に対し、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

△ 電池について


- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投げない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後直ちに医師の治療を受ける。
- 電池は乳幼児の手の届く場所に置かない。万一飲み込んだ場合は直ちに医師の治療を受ける。
- 電池の極性(+-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を中止する。

各部の名称


※本書に記載されているイラストはイメージです。

※ご使用の前に電池カバーを開け、絶縁シートを抜き取ってください。

表面

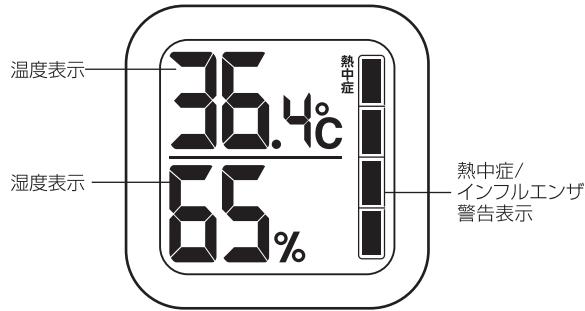

裏面

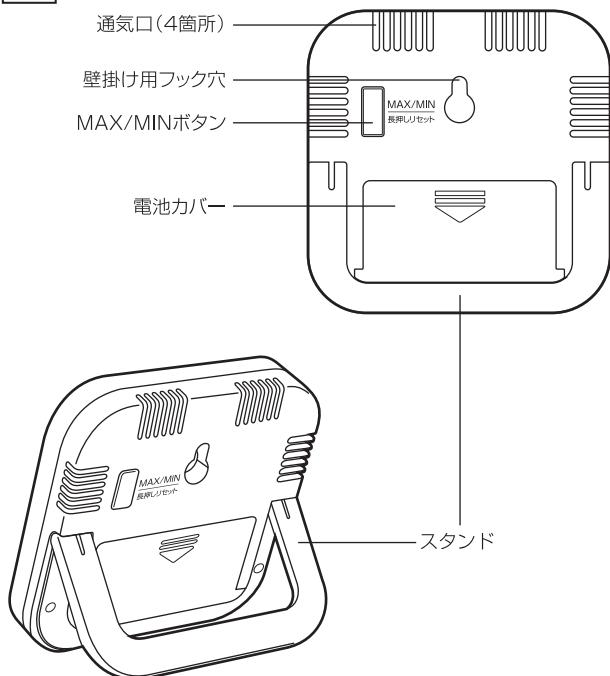


電池交換

●電池寿命：約1年

※付属の電池は動作確認用ですので、電池寿命は短い場合があります。

1. 本体裏面のスタンドを開き、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。
2. 古い電池を取り出し、新しい電池をセットします。
※電池の極性 (+・-) を間違わないように入れてください。
3. 電池カバーをスライドさせて閉じます。

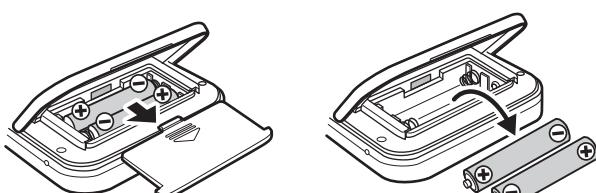

熱中症の警告表示について

本製品は熱中症の危険度をバー表示でお知らせします。

(下記参照)

※熱中症とインフルエンザ、どちらの表示も出ない範囲があります。

	注意	警戒	厳重警戒	危険
熱中症 (WBGT) ※WBGT 21℃未満 警報表示 なし				

■ 热中症とは (出典 ひと涼みしよう 热中症予防 声かけプロジェクト)

熱中症は、気温が高いことなどで、身体の中の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体の調整機能が正常に働かなくなることによって引き起こされます。人の身体は、常に熱を作り出す一方、汗をかいり、皮膚から熱を逃がすことで、体温の上昇を抑えています。このような体温の調節機能がうまく働かず、体内に熱がこもり、体温が異常に上昇することで熱中症は起ります。また、真夏日や熱帯夜が多い年は、熱中症で亡くなる人も増えます。一般的には、最高気温が25度を超えると患者が発生し、30度を超えると熱中症で死亡する人の数が増えはじめると言われています。

日常生活における熱中症予防指針

(出典 日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.3 確定版)

温度基準 (WBGT)	注意すべき 生活活動の目安	注意事項
危険 (31℃以上)	すべての生活活動で おこる危険性	高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。
厳重警戒 (28~31℃)		外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。
警戒 (25~28℃)	中等度以上の生活活動で おこる危険性	運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れる。
注意 (25℃未満)	強い生活活動で おこる危険性	一般的に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。

熱中症の症状と対策

- ・注 意：熱中症の危険は少ないですが、兆候に注意しましょう。
スポーツなどの活動をしている方は、適度な水分補給を心がけましょう。
- ・警 戒：熱中症の危険が増しています。
スポーツなどの活動をしている方はこまめに休息を取り積極的に水分補給をしましょう。激しい運動は30分おきくらいに休息を取りましょう。
- ・厳重警戒：熱中症の危険が高まっています。
スポーツなどの活動をしている方は激しい運動を避けてください。体力の低い方、暑さに慣れていない方は運動を中止してください。
- ・危 險：熱中症の危険があります。
特別の場合以外はすべての運動を中止してください。体温の上昇に注意し、十分な休息と水分補給を行ってください。